MANI! AUTUMN

Seasonal Campaign

2026
10/21
▼
11/20



Topics! 新製品情報

埋伏智歯分割用サージカルバー
1559L 新発売！

IPR用ダイヤバー、
中間ファイルキャンペーン追加！

MANI 株式会社モリタ

CAD/CAMセレクション

CAD/CAMに対応したマニーセレクションのご紹介!

DIA-BURS
CAD / CAM
SELECTION

※ 先端径とテーパー角の数値は参考値です



WEBセミナー配信中!

ご視聴はこちら

歯科医師 **北道 敏行** 先生


北道歯科医院 ご開業　日本臨床歯科CADCAM学会 会長
株式会社モリタ CADCAMインストラクター

TR-13/TR-13EF



隣接面





WHY? ・マージンはディープシャンファーが求められるため、先端径が太くラウンド形態を持つTR-13が適している
・スリムな形態なので、隣接歯に接触させずに隣接面を形成できる


MERIT ・隣接面では隣接歯を傷つけないようにするため、コントロールしやすいテーパーを選択している

POINT ・歯の長軸に沿って保持し、隣接歯を保護しながら均一なクリアランスを確保する

MP-5/MP-5EF



グルーブ　切　縁　軸面歯質除去

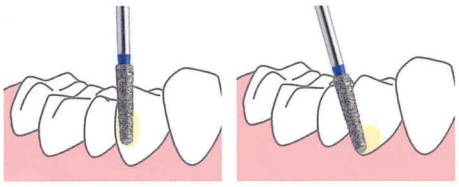


WHY? ・先端がラウンドのため、テーパー付与が容易、グルーブから軸面・切縁形成まで対応可能

MERIT ・片側の軸面テーパーで求められる角度に適した4°のテーパー角
・ラウンド形状のため、丸みのあるマージンを形成でき、スキャナーでの読み取り精度が高まる

POINT ・歯の長軸に合わせてバーを動かし、連続した形成ラインと均一なテーパーをつける

EX-21/EX-21EF

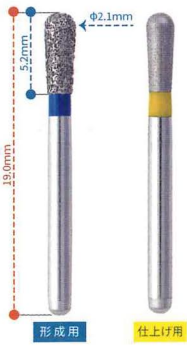

咬合面



WHY? ・ピアー形状により、頬側および舌側の二方向からのアプローチが可能
・形成後の咬合面中央に不要な段差やラインが残りにくい


MERIT ・咬合面中央での段差形成を抑え、スムーズな形成と高いスキャン適性を両立できる

POINT ・歯の長軸に沿って保持し、隣接歯を保護しながら均一なクリアランスを確保する

MP-10/MP-10EF



舌側・口蓋側




WHY? ・前歯舌側の複雑な解剖学的曲面に沿いやすい形状設計


MERIT ・舌側で生じやすいクリアランス不足や鋭角的な線角の発生を抑制できる

POINT ・舌側・口蓋側の形成時には、軽圧で均等に当て、歯肉縁付近はなめらかに仕上げることを意識する

EX-38/EX-38EF

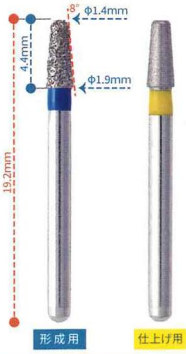

窩　洞



WHY? ・先端に適度なラウンドを付与した形状により、内部形態に鋭角が残りにくい

MERIT ・窩洞形成で求められる鋭角を避けた形成が可能

POINT ・バーを歯の長軸に沿ってまっすぐ保持し、窩縁部は軽く垂直方向に当てて直角マージンを意識する

支台歯形成に特化したMPシリーズをキャンペーンに追加!



※表組中の画像は原寸です。


品番		MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	MP-9	MP-10	MP-11	MP-12F
形成部		マージン形成	隣接面除去	軸面形成(先端ダイヤ無)	軸面形成(先端ダイヤ有)	隣接部軸面形成(先端ダイヤ有)	咬合面削除	中心窩形成	咬合面形成	形成用デプスマーカー	舌面形成(大)	舌面形成(小)	エンドカッティング
形状		ISO 001/012 1.2/23.0	ISO 166/014 10.2/22.0	ISO 219/022 9.2/22.5	ISO 198/016 9.3/22.5	ISO 198/022 9.4/22.5	ISO 238/014 4.4/21.4	ISO 463/019 2.0/18.6	ISO 032/032 5.1/19.5	ISO 073/028 1.4/23.2	ISO 277/024 4.6/20.7	ISO 277/021 4.1/19.2	ISO 150/010 8.0/21.3
最高許容回転数(min⁻¹)		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	160,000	300,000	300,000	300,000
砥粒サイズ	スタンダード(106-125μm)	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8	MP-9	MP-10	MP-11	–
	ファイン(53-63μm)	MP-1F	–	MP-3F	MP-4F	MP-5F	–	MP-7F	MP-8F	MP-9F	MP-10F	MP-11F	MP-12F
	エクストラファイン(20-30μm)	–	–	–	MP-4EF	MP-5EF	–	–	–	–	MP-10EF	MP-11EF	–

ダイヤバーFGブリスターパック

医療機器届出番号　09B1X00006002010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名　マニーダイヤバー

ダイヤバー スーパーコース

当社ダイヤバーでの比較

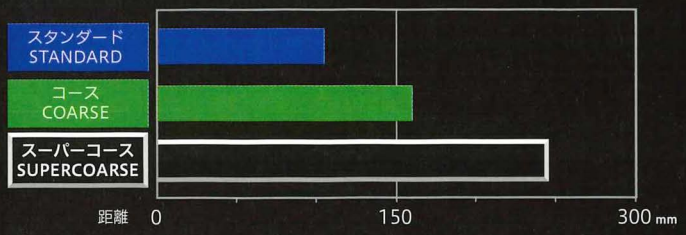

● 許容回転数で切削量を比較したグラフ。　※切削対象物：エナメル質と同等の物質



〈参考写真〉栃木県宇都宮市開業　やまうち歯科 secondstage：山内聡先生

スタンダードを使用するよりも、治療効率がよくなります。

Super Coarse	ISO 039/034 5.1/19.2 EX-11SC	ISO 237/023 5.3/19.1 EX-21SC	ISO 237/034 5.1/19.1 EX-26SC	ISO 257/034 5.2/19.2 FO-27SC	ISO 141/014 8.3/22.3 SR-11SC	ISO 166/018 10.3/22.1 TC-11SC	ISO 173/018 10.3/21.9 TF-12SC	ISO 170/023 5.6/19.1 TF-22SC	ISO 170/018 4.3/19.1 TF-31SC	ISO 197/018 7.3/21.2 TR-21SC	ISO 198/020 9.3/21.9 TR-13SC		
Coarse	ISO 508/019 9.6/21.0 FO-54C	ISO 166/017 10.1/22.0 TC-11C	ISO 173/019 10.2/21.8 TF-13C	ISO 198/019 9.2/21.8 TR-13C	ISO 197/018 7.2/20.0 TR-62C	ISO 072/043 2.0/19.2 WR-13C	Standard	ISO 002/018 2.4/19.1 BC-31	ISO 002/016 3.6/19.1 BC-32	ISO 002/014 2.5/19.1 BC-42	ISO 002/012 2.6/19.1 BC-43	ISO 001/018 1.6/19.1 BR-31	
ISO 001/014 1.3/19.1 BR-41	売れ筋 No.2 ISO 001/010 0.9/19.1 BR-45	ISO 001/012 1.1/19.1 BR-46	売れ筋 No.4 ISO 001/008 0.7/19.0 BR-49	ISO 032/011 2.4/19.1 DI-41	ISO 032/014 3.3/19.1 DI-42	ISO 039/032 5.0/19.1 EX-11	ISO 039/035 7.2/20.1 EX-12	★ ISO 553/019 10.4/23.2 EX-17	ISO 237/018 5.2/19.1 EX-20	ISO 237/021 5.2/19.0 EX-21	ISO 190/017 10.1/24.0 EX-24	売れ筋 No.5 ISO 239/032 5.0/19.0 EX-26	
★ ISO 545/018 7.2/21.2 EX-29	ISO 237/014 4.3/19.1 EX-31	★ ISO 544/019 4.4/19.2 EX-38	ISO 237/011 3.1/19.1 EX-41	ISO 299/014 10.2/24.1 FO-11	ISO 297/014 7.2/21.1 FO-21	ISO 288/016 7.2/21.1 FO-22	ISO 257/028 5.0/19.1 FO-25	ISO 257/032 5.0/19.1 FO-27	ISO 257/018 3.9/19.7 FO-32	ISO 111/012 8.2/22.1 SF-11	ISO 111/014 8.2/22.0 SF-12	ISO 111/016 8.2/22.1 SF-13	
ISO 110/014 7.2/21.0 SF-21	ISO 109/013 4.7/19.1 SF-31	ISO 109/011 4.3/19.0 SF-41	ISO 010/013 1.4/19.0 SI-46	ISO 010/015 1.8/19.0 SI-47	ISO 010/017 1.9/19.0 SI-48	ISO 297/012 6.2/21.0 SO-20	ISO 298/014 8.2/21.8 SO-21	ISO 141/012 8.2/22.2 SR-11	ISO 141/014 8.2/22.2 SR-12	ISO 141/016 8.2/22.2 SR-13	ISO 160/016 10.2/22.2 TC-11	ISO 166/018 10.4/23.2 TC-16	
ISO 165/014 8.2/22.0 TC-21	ISO 164/011 6.1/21.2 TC-26	ISO 173/014 10.2/24.0 TF-11	ISO 173/016 10.2/21.8 TF-12	ISO 173/018 10.2/21.8 TF-13	ISO 172/023 9.3/21.8 TF-14	ISO 171/014 7.2/21.0 TF-20	ISO 171/016 7.2/21.0 TF-21	売れ筋 No.3 ISO 170/021 5.5/19.0 TF-22	ISO 170/018 5.2/20.1 TF-23	ISO 170/016 4.2/19.0 TF-31	ISO 169/011 3.7/19.1 TF-41	ISO 170/012 4.2/19.0 TF-42	
ISO 170/014 4.2/19.0 TF-43	ISO 199/016 10.2/21.8 TR-11	ISO 199/016 10.2/21.8 TR-12	売れ筋 No.1 ISO 198/018 9.2/21.8 TR-13	ISO 198/022 9.3/22.0 TR-14	ISO 199/022 11.4/23.8 TR-15	ISO 199/023 11.4/23.8 TR-19	ISO 197/014 7.2/21.0 TR-20	ISO 197/016 7.2/21.1 TR-21	ISO 197/018 7.2/21.2 TR-24	ISO 199/016 10.2/21.7 TR-25	ISO 198/018 9.2/21.8 TR-26	ISO 041/024 0.6/19.2 WF-30	
ISO 072/042 1.9/19.1 WR-13	Short Shank	BC-S42 ISO 002/014 2.5/16.7 BC-S42	ISO 002/012 2.6/16.7 BC-S43	ISO 001/010 0.9/16.7 BR-S45	ISO 001/012 1.1/16.7 BR-S46	ISO 032/011 2.4/17.2 DI-S41	ISO 297/014 7.2/18.2 FO-S21	ISO 508/019 9.6/20.0 FO-S54	ISO 001/008 1.0/17.1 MI-S45	ISO 277/024 4.8/17.1 Pro-S3	ISO 109/011 3.8/16.7 SF-S41	ISO 010/013 1.4/16.6 SI-S46	

ダイヤバーFGブリスターパック

医療機器届出番号　09B1X00006002010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名　マニーダイヤバー



特別価格

■標準価格(5本入／1シート)
スーパーコース
~~6,000円~~(税別)

特別価格

■標準価格(5本入／1シート円)
コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン
~~4,500円~~(税別)

ダイヤバー
形態表の見方



ISO 010/017 1.9/16.6 **SI-S48**	ISO 297/012 6.2/18.8 **SO-S20**	ISO 165/014 8.2/20.0 **TC-S21**	ISO 173/016 10.3/21.2 **TF-S12**	ISO 171/014 7.2/18.8 **TF-S20**	ISO 171/016 7.2/18.8 **TF-S21**	ISO 170/021 5.5/16.9 **TF-S22**	ISO 170/018 5.2/17.1 **TF-S23**	ISO 170/016 4.2/16.8 **TF-S31**	ISO 169/011 3.7/16.8 **TF-S41**	ISO 299/018 9.6/20.9 **TR-S13**	ISO 198/022 9.3/20.1 **TR-S14**	ISO 197/016 7.2/18.8 **TR-S21**
Super Short Shank	ISO 138/009 2.3/16.1 **CD-SS51**	ISO 032/011 2.4/14.5 **DI-SS41**	ISO 297/014 6.1/16.1 **EX-SS13**	ISO 197/015 6.1/16.1 **EX-SS14**	★ ISO 544/016 4.2/14.3 **EX-SS33**	★ ISO 544/019 4.5/16.1 **EX-SS38**	ISO 165/014 8.2/17.1 **TC-SS21**	ISO 170/016 4.2/14.3 **TF-SS31**	ISO 197/016 7.2/17.7 **TR-SS21**	**Fine**	ISO 001/006 0.5/19.0 **BR-48F**	ISO 001/006 0.6/16.7 **CD-50F**
ISO 138/007 2.2/16.7 **CD-51F**	ISO 139/007 3.8/16.7 **CD-52F**	ISO 539/007 2.2/16.7 **CD-53F**	ISO 295/007 2.2/16.7 **CD-54F**	ISO 277/008 1.2/16.7 **CD-55F**	ISO 295/007 2.2/16.7 **CD-56F**	ISO 295/007 3.6/16.7 **CD-57F**	ISO 156/009 3.2/16.2 **CD-58F**	ISO 197/013 6.9/16.7 **CD-59F**	ISO 138/007 2.2/19.0 **CD-60F**	ISO 139/007 3.8/19.0 **CD-61F**	ISO 156/009 3.2/19.0 **CD-62F**	ISO 546/021 9.1/21.7 **CE-12F**
ISO 544/020 5.3/18.9 **CE-13F**	ISO 254/027 4.8/20.6 **CE-15F**	ISO 198/017 9.1/21.7 **CE-16F**	ISO 546/011 8.1/21.9 **CE-17F**	ISO 196/020 5.1/19.0 **CR-11F**	ISO 196/015 4.1/19.0 **CR-12F**	ISO 197/012 7.1/21.5 **CR-21F**	ISO 298/013 8.1/21.5 **CR-22F**	ISO 179/010 9.2/21.0 **EX-18F**	拡大図	ISO 237/020 5.1/18.9 **EX-21F**	ISO 237/013 4.2/19.0 **EX-31F**	ISO 297/013 7.1/21.0 **FO-21F**
ISO 288/015 7.1/21.0 **FO-22F**	ISO 257/015 3.2/19.0 **FO-30F**	ISO 198/020 8.1/22.1 **Pro-1f**	ISO 198/017 8.2/22.1 **Pro-2f**	ISO 277/022 4.7/20.6 **Pro-3f**	ISO 237/019 5.1/19.1 **Pro-4f**	ISO 041/039 0.7/19.1 **Pro-5f**	ISO 166/015 10.1/21.9 **TC-11F**	ISO 165/013 8.1/21.9 **TC-21F**	ISO 173/015 10.1/21.7 **TF-12F**	ISO 171/015 7.1/20.9 **TF-21F**	ISO 199/015 10.1/21.7 **TR-11F**	ISO 198/017 9.1/21.7 **TR-13F**
ISO 197/015 7.1/21.0 **TR-21F**	ISO 199/015 10.1/21.6 **TR-25F**	ISO 198/017 9.1/21.7 **TR-26F**	ISO 072/015 0.6/19.1 **WR-31F**	**Short Shank**	ISO 072/015 0.6/16.6 **WR-S31F**	**Super Short Shank**	ISO 298/013 7.7/18.1 **FO-SS21F**	ISO 165/012 8.2/18.1 **TC-SS21F**	**Extra Fine**	ISO 001/015 1.4/18.9 **BR-40EF**	ISO 546/019 8.9/21.6 **CE-12EF**	ISO 544/019 5.1/18.8 **CE-13EF**
ISO 254/025 4.6/20.5 **CE-15EF**	ISO 198/015 8.9/21.6 **CE-16EF**	ISO 196/019 4.9/18.9 **CR-11EF**	ISO 196/013 3.9/18.9 **CR-12EF**	ISO 237/018 4.9/18.8 **EX-21EF**	IISO 218/012 7.0/21.0 **EX-27EF**	ISO 545/018 6.9/21.0 **EX-29EF**	ISO 138/015 3.3/19.0 **EX-36EF**	ISO 254/023 1.9/19.0 **EX-37EF**	★ ISO 544/018 4.2/18.9 **EX-38EF**	ISO 257/012 6.0/19.9 **FO-20EF**	ISO 297/011 6.9/20.9 **FO-21EF**	ISO 288/013 6.9/20.9 **FO-22EF**
ISO 257/014 3.1/18.9 **FO-30EF**	ISO 540/009 4.2/23.4 **FO-40EF**	ISO 297/009 5.9/18.4 **FO-41EF**	ISO 289/010 7.6/21.9 **FO-42EF**	ISO 198/021 8.8/22.0 **Pro-1EF**	ISO 198/018 7.9/18.9 **Pro-2EF**	ISO 166/013 9.9/21.8 **TC-11EF**	ISO 165/011 7.9/21.8 **TC-21EF**	ISO 173/013 9.9/21.6 **TF-12EF**	ISO 171/013 6.9/20.8 **TF-21EF**	ISO 199/013 9.9/21.6 **TR-11EF**	ISO 198/015 8.9/21.6 **TR-13EF**	ISO 197/013 6.9/20.9 **TR-21EF**
ISO 199/013 9.9/21.5 **TR-25EF**	ISO 198/015 8.9/21.6 **TR-26EF**	**Short Shank**	ISO 198/019 8.9/19.9 **TR-S14EF**	**Super Short Shank**	ISO 297/012 5.9/15.9 **EX-SS13EF**	ISO 197/012 5.9/15.9 **EX-SS14EF**	★ ISO 544/015 4.0/14.2 **EX-SS33EF**	★ ISO 544/018 4.2/15.9 **EX-SS38EF**				

スーパーコース(SC)/180-212μm
コース(C) /125-150μm
スタンダード(S) /106-125μm
ファイン(F) /53-63μm
エクストラファイン(EF)/20-30μm




★印 ショルダーR
EX-17、EX-29、
EX-38、
EX-SS33、
EX-SS38、
EX-SS33EF、
EX-SS38EF

IPR-01EF

医療機器届出番号　09B1X00006002010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ダイヤモンドバー
販売名　マニーダイヤバー

マニー史上最細のダイヤバー

先端径はアライナー矯正時のIPR最小値である0.2mmよりも細い、「0.19mm」に設計。さらにテーパーを最小限にすることで、綺麗な形成を可能にします。

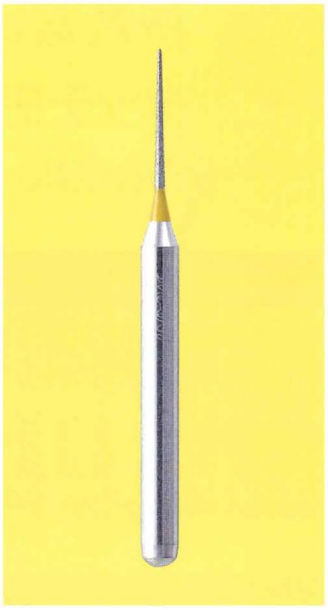

このようなIPR時のストレスを軽減します

振動が頭に響く
歯間削合する際、削る振動が直接頭に響くことで、患者様を不快にするおそれがあります。


患者様のストレスが術者にも伝染
患者様のストレスが術者にも伝わり、「急がないと」という術者の負担につながりやすいです。

長い所要時間
削合歯数が多いケースでは、削合効率の悪さにより、施術に数日かかることもあります。

●使用方法　許容回転数：16万回転以下



隣接面の歯頸部から切端に向けて引き上げてください。
頬舌側どちらからもご使用いただけます。

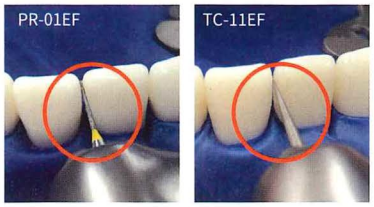

当社製品サイズ比較

特別価格

■標準価格（5本入／1ケース）
IPR-01EF
~~5,200円~~（税別）

サージカルバー【シャンクタイプ：FG】

医療機器届出番号　09B1X00006003010
一般医療機器　一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名　マニーカーバイドバー

新発売！

埋伏智歯分割用 サージカルバー（1559L）
効率的でスムーズな歯牙分割のために




01 スパイラルブレード形状
刃部形状の最適化により、スムーズな切削を可能に。従来のブレードに比べて振動が少なく、安定した操作へ。

02 クロスカット構造
クロスカットブレードにより、切削効率を向上

03 作業部長6mm
従来品（Zekryaタイプ：11mm）に比べて短く設計し、コントロール性を高めるとともに、軟組織の巻き込み低減を目指した。

04 ネック形状
最適なネック形状で、耐破折性を向上

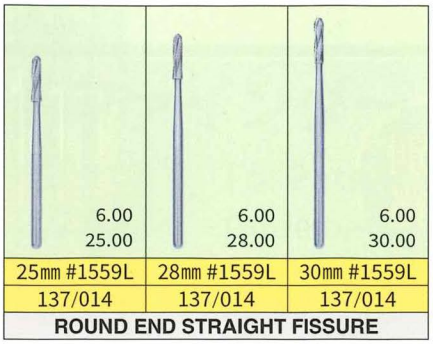


6.00 / 25.00	6.00 / 28.00	6.00 / 30.00
25mm #1559L	28mm #1559L	30mm #1559L
137/014	137/014	137/014

ROUND END STRAIGHT FISSURE

“もう少しで届くのに”という歯痒い思いをなくします。

半チャックで使用していた悩みを解決！ロングテーパーであるため視野の確保が可能。埋伏歯、メタルポスト、メタルコア、ファイバーコアなどの除去に効果を発揮！ ※5倍速コントラを推奨します。

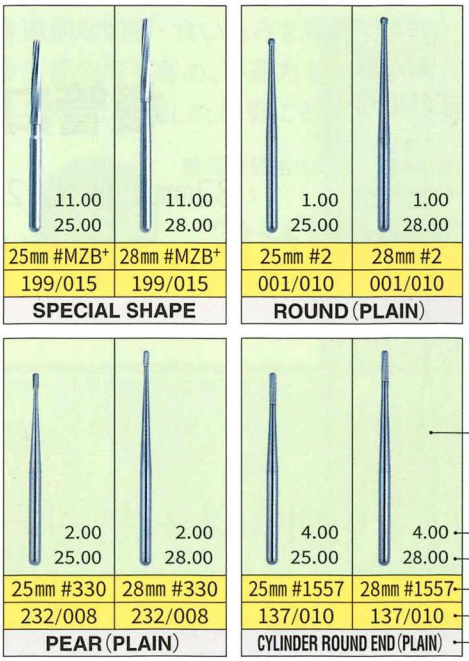

11.00 / 25.00	11.00 / 28.00	1.00 / 25.00	1.00 / 28.00
25mm #MZB+	28mm #MZB+	25mm #2	28mm #2
199/015	199/015	001/010	001/010
SPECIAL SHAPE		ROUND（PLAIN）	

2.00 / 25.00	2.00 / 28.00	4.00 / 25.00	4.00 / 28.00
25mm #330	28mm #330	25mm #1557	28mm #1557
232/008	232/008	137/010	137/010
PEAR（PLAIN）		CYLINDER ROUND END（PLAIN）	

サージカルバー形態表の見方
- 最高許容回転数 120,000min⁻¹
- 作業部長 / 全長
- 注文番号
- 形状/最大径
- 形状

特別価格

■標準価格（4本入／1ケース）
MZB+、#1559L
~~2,800円~~（税別）

特別価格

■標準価格（4本入／1ケース）
#2、#330、#1557
~~2,300円~~（税別）

Mカーバイドバー＋【シャンクタイプ:FG】

医療機器届出番号　09B1X00006003010
一般医療機器　一般的名称：歯科用カーバイドバー
販売名　マニーカーバイドバー

除去用バー特集

折れない工夫、切れる設計！
タッチ感に変化。

売れ筋No.1～No.5のご紹介！

詳細はこちら



※写真の商品は Ⅰクラス【45形態】

売れ筋No.1 ○	売れ筋No.2 ○	売れ筋No.3 ○	売れ筋No.4 ○	売れ筋No.5 △
137/010 4.00/19.30 M1557	232/008 2.00/19.30 M330P	232/008 2.00/19.30 M330	137/012 4.00/19.30 M1558	137/012 4.00/19.00 M1958
CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)	PEAR (PLAIN)	PEAR (PLAIN)	CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)	REMOVAL (CROSSCUT)

特別価格

■標準価格
（10本入／1シート）
Ⅰクラス
~~2,100~~円（税別）


特別価格

■標準価格
（10本入／1シート）
Ⅱクラス
~~2,800~~円（税別）

特別価格

■標準価格
（10本入／1シート）
Ⅲクラス
~~10,600~~円（税別）

形態表の見方



30万回転　300,000min-1
20万回転　200,000min-1
15万回転　150,000min-1

最小包装単位
○Ⅰクラス
10本入り/シート
△Ⅱクラス
10本入り/シート
◎Ⅲクラス
10本入り/シート

AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN

ピーソリーマ・ゲーツドリル【シャンクタイプ:CA】

医療機器承認番号　22000BZX01630000
管理医療機器　一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名　マニーピーソリーマ

医療機器承認番号　22000BZX01631000
管理医療機器　一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル
販売名　マニーゲーツドリル



根管口の拡大にはこれ！

32㎜に加え、28㎜は小児や臼歯部の治療に！
38㎜は犬歯などに有効です。



特別価格

■標準価格（6本入／1個）
#1～6
~~3,300~~円（税別）


特別価格

■標準価格（6本入／1個）
#1～6
~~3,300~~円（税別）


穿通ファイル特集

Your Endodontic Compass to find the right Path
－どんな症例でも迷わずに穿通、グライドパスができることを目指して－

Dファインダー








Dの断面形状で切削力をおさえる


切削力を抑えているため、刃が食い込みにくく、レッジ・パーフォレーションを起こしにくい。


滑りながらすすむ

最初は
Dファインダー

グライド ファインダー







可変断面で
切削性・柔軟性をもたせる

切削力があるため、過度に石灰化・狭窄した根管でも、削りながら穿通ができる。

削りながらすすむ

進まない時は
グライド
ファインダー

グライドパス　JIZAI Pre 013 ／ Pre 020

Dファインダーとグライドファインダーを用いた石灰化根管・湾曲根管の穿通法

— 8-10 Technique —　CLINICAL CASE REPORT




石崎 秀隆 先生
岡口歯科クリニック（東京都）
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科
歯周歯内治療学分野

詳細はこちら


AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN

Dファインダー

医療機器届出番号　09B1X00006011050
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーDファインダー

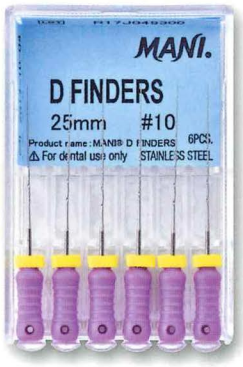

Exclusively designed for Patency

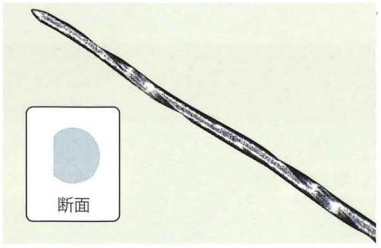

特徴的なD型断面

- 過剰な切削・食い込みを軽減できる。
- 刃部強度を高め、穿通力をUP。
- 石灰化、狭窄した根管にも折れにくく有効。

特別価格

■標準価格（6本入／1個）
#8～15
~~3,800円~~（税別）


SPRING SEASONAL CAMPAIGN

グライドファインダー

医療機器届出番号　09B1X00006011010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーKファイル



For Patency and Glide path

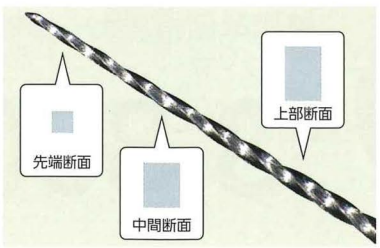

穿通性＋切削性

- 先端部テーパーを強化し力が伝わりやすい。
- 断面形状の変化による優れた切削性と柔軟性。
- 穿通のみならずグライドパス形成も可能。

特別価格

■標準価格（6本入／1個）
#8～15
~~3,000円~~（税別）

中間リーマ・中間Kファイル・中間Hファイル

医療機器届出番号　09B1X00006010010
一般医療機器　一般的名称：歯科用根管リーマ
販売名　マニーリーマ

医療機器届出番号　09B1X00006011010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーKファイル

医療機器届出番号　09B1X00006011020
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーHファイル

段階的な拡大で負担を軽減！
破折リスクを抑える安心設計。




中間ファイルの特徴

豊富なラインナップ

サイズ	先端径(mm)
12	0.12
17	0.17
22	0.22
27	0.27
32	0.32
37	0.37

製品ご使用前に電子添文を必ずお読みください。

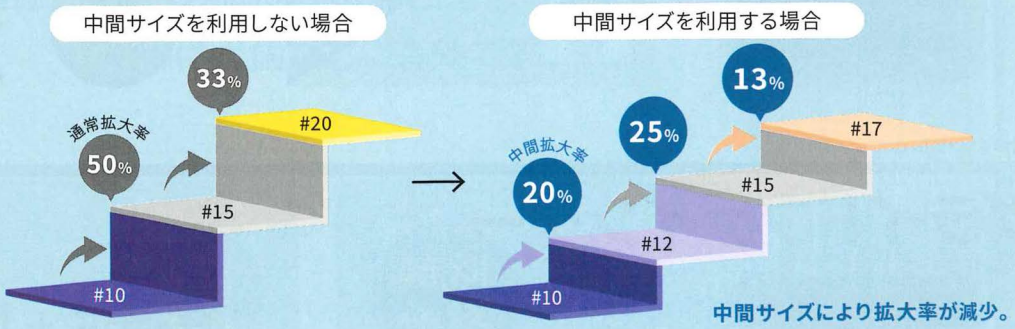

特別価格

■標準価格(6本入／1個)
#12～37
~~3,800円~~(税別)

AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN

リーマ

医療機器届出番号　09B1X00006010010
一般医療機器　一般的名称：歯科用根管リーマ
販売名　マニーリーマ



●材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP！
●シャープなエッジにより切れ味を高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上！
●ラバーストッパーの色と形により、長さと操作方法が容易に分かります。

特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#10～40
~~2,400~~円（税別）

特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#06、08、45～80
~~3,000~~円（税別）

AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN

Kファイル

医療機器届出番号　09B1X00006011010
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーKファイル



特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#10～40
~~2,400~~円（税別）

特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#06、08、45～80
~~3,000~~円（税別）

AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN

Hファイル

医療機器届出番号　09B1X00006011020
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーHファイル



特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#10～40
~~2,400~~円（税別）

特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#08、45～80
~~3,000~~円（税別）

AUTUMN SEASONAL CAMPAIGN


RTファイル

医療機器届出番号　09B1X00006011040
一般医療機器　一般的名称：歯科用ファイル
販売名　マニーRTファイル



RTファイルの特徴

追従性　余計なところを削らず、楽に根管形状の維持




Kファイルよりも柔軟性があります

効率的　Kファイルと比べ、170%の切削力効率がよく、治療の時短に



安全性　伸びが分かることによって交換時期の判別を





RTファイルは『レクタングル（長方形）』の断面形状を持っています。一方、Kファイルは正方形の断面をしているため、刃の形状が異なります。長方形は①切削力②柔軟性③耐破折性④排出性を向上させます。

作業部長 ＼ サイズ	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
21mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
28mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
31mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

術者を、手の痛みとストレスから解放する新たな選択。



特別価格
■標準価格（6本入／1個）
#15～40
~~2,400~~円（税別）

GPR【シャンクタイプ:CA】

医療機器認証番号　306ABBZX00019000
管理医療機器　一般的名称：電動式歯科用螺旋状除去器
販売名　マニーGPR

再根管治療の常識を覆す

革新的なガッタパーチャ除去ツール

より速く、より簡単に。
面倒なガッタパーチャ除去を効率化。
従来の溶解剤を使用する方法では、時間がかかり、除去作業が煩雑でしたが、
GPRはシンプルな操作でよりスピーディーにガッタパーチャを除去します。
どんなハンドピースにも対応し、特別な設備も必要ありません。
これにより、再根管治療の手間を軽減し、チェアタイムを短縮します。

タイプ	先端径(mm)	
1S	0.70	
2S	0.50	
3N	0.40	
4N	0.30	

S＝ステンレススチール　N＝ニッケルチタン


用　途

根管内の充填物を
除去するために用いる


組合せ(4通り)

1S → 3N　2S → 3N
1S → 4N　2S → 4N

■最小包装単位:4本入／ケース
■アソート(ASS):1S(#70)、2S(#50)、3N(#40)、4N(#30)
■テーパー:4/100　■材質:ステンレススチール、ニッケルチタン

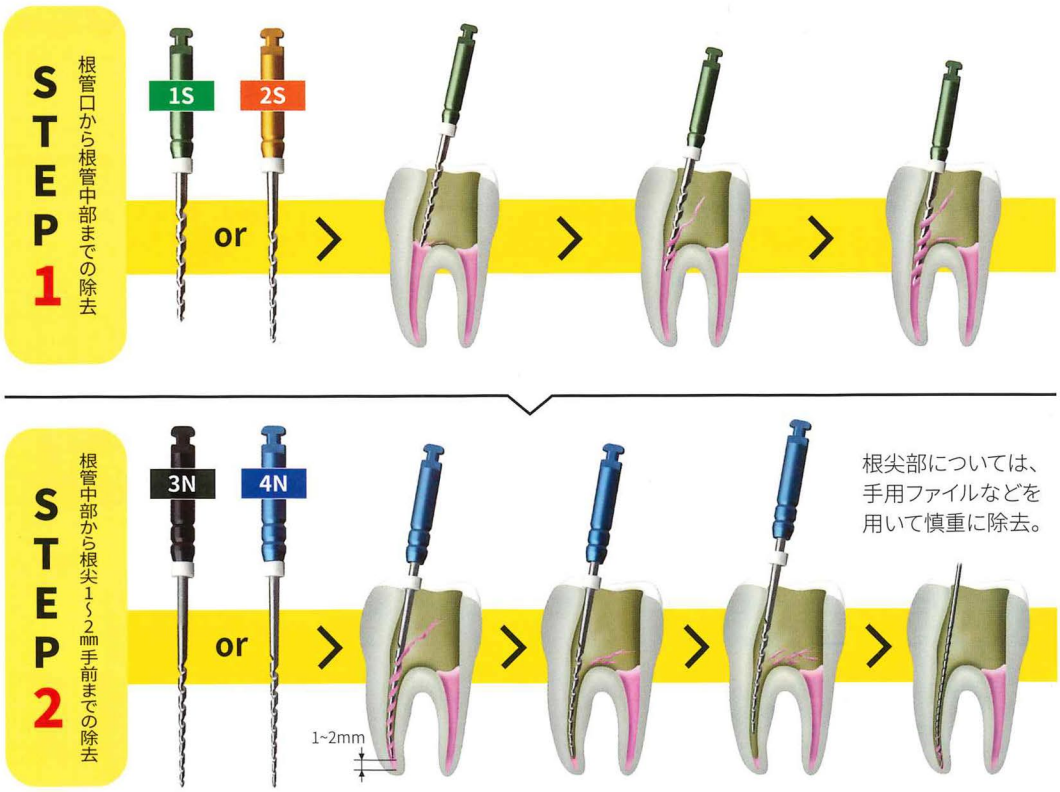

症例

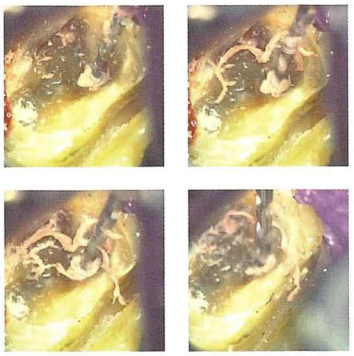

※〈症例写真〉日本大学松戸歯学部
歯内療法学講座 臨床教授　辻本恭久先生

●推奨回転数
1000~1500min^{-1}
●トルク設定
溶解剤・注水　不要

特別価格

■標準価格(4本入／1個円)
#1S、2S
~~2,600円~~(税別)

特別価格

■標準価格(4本入／1個)
#3N、4N
~~5,200円~~(税別)

特別価格

■標準価格(4本入／1個)
アソート(ASS)
~~3,900円~~(税別)

JIZAI

医療機器認証番号：301ABBZX00035000
管理医療機器　　一般的名称：電動式歯科用ファイル
販売名：マニーNiTi ファイル

製品カタログ　使用マニュアル



柔軟性が高いため疲労破折に強く、根管に追従します



ラジアルランド
刀部に面を設けることで
過度な食い込みを抑える。



切削点
切削点を減らすことで
ファイルに掛かる負担を減らし、
破折防止につなげる。


JIZAI Pre 013
JIZAI Pre 020



切削点

JIZAI Ⅰ（025/04）
JIZAI Ⅱ（025/06）
JIZAI Ⅲ（035/04）等

使用手順

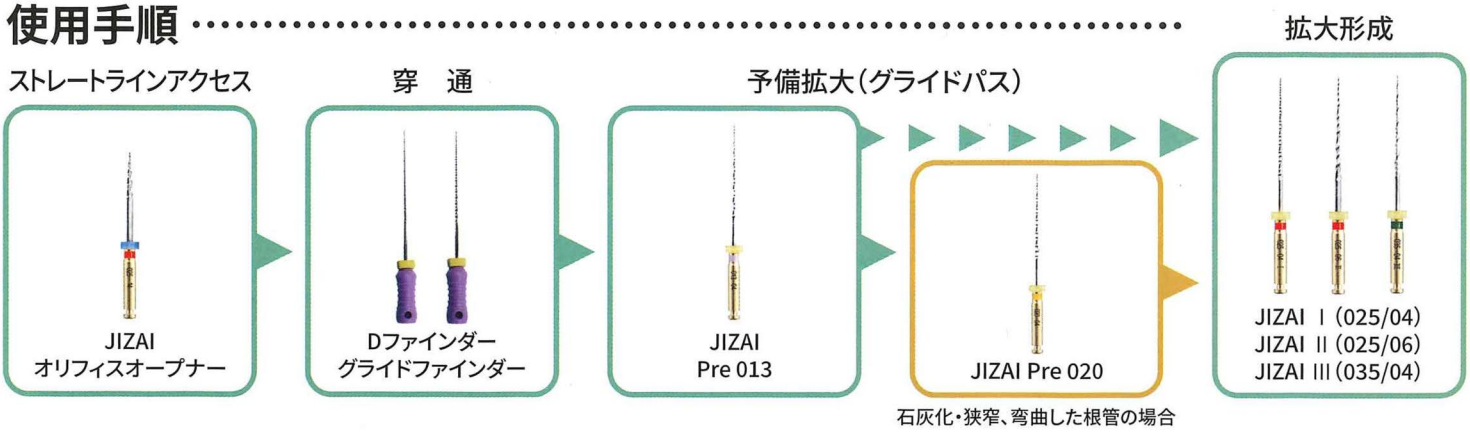

特別価格

JIZAI グライドパスセット

■標準価格（3本入／1個）

~~6,000円~~（税別）

特別価格

JIZAI シェイピングセット

■標準価格（3本入／1個）

~~6,000円~~（税別）

規　格	サイズ	テーパー	長　さ	入　数	標準価格
グライドパスセット					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	各1本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm		
Pre 020	020	04	25mm		
シェイピングセット					
Ⅰ	025	04	21mm 25mm	各1本入	6,000円
Ⅱ	025	06			
Ⅲ	035	04			

規　格	サイズ	テーパー	長　さ	入　数	標準価格
単　品					
オリフィスオープナー	025	14	18mm	各3本入	6,000円
Pre 013	013	04	21mm 25mm		
Pre 020	020	04			
025 04	025	04			
030 04	030	04			
035 04	035	04			
040 04	040	04			
045 04	045	04			
050 04	050	04			
025 06	025	06			
030 06	030	06			
035 06	035	06			

各種単品でも特別価格でご提供いたします。

JIZAIトレーニングを動画で解説！

トレーニングセットの使用手順や操作方法を、デモ動画でわかりやすく紹介しています。

3次元的に弯曲した根管模型を使用し、JIZAIのコツを動画でご紹介します。

モーター設定方法

トレーニング動画



伊澤 真人 先生
鳩ケ谷いざわ歯科　院長

主な臨床別推奨 滅菌済針付縫合糸

監 修

歯周病専門医・指導医 **和泉雄一 先生**
(総合南東北病院 オーラルケア・ペリオセンター長)

歯周病専門医・指導医 **秋月達也 先生**
(間瀬デンタルクリニック)

【単純縫合】

● 抜歯(水平埋伏智歯)



No.24 (3-0 シルク/ブレイド)を使用。抜歯手術などには、太めの3-0で縫合することもある。切開した部分のみを縫合し、排膿路を確保しておくと術後の腫脹が少ない。

● フラップ手術-1



No.3 (4-0 シルク/ブレイド)を使用。逆三角針は貫通力が高く厚くて硬い口蓋の歯肉も容易に針を通せる。長い針は頬舌への針の移動が容易である。

● フラップ手術-2



No.19 (5-0 ナイロン/モノ)を使用。細い針と5-0の糸により細やかな縫合を行うことができ、モノフィラメントのため、プラークの付着も少ない。

【X字縫合】

● 単純抜歯



No.3(4-0 シルク/ブレイド)を使用。抜歯後の治療には縫合の有無は関係ないとの報告もあるが、血餅の保持、患者の安心という点から縫合するメリットもある。

縫合手術動画

【垂直マットレス縫合】

● フラップ手術



No.3(4-0 シルク/ブレイド)を使用。緊密に弁を合わせる事ができる縫合法である。

縫合手術動画

【懸垂縫合】


● フラップ手術



No.3 (4-0 シルク/ブレイド)を使用。フラップの適合を考えて様々な縫合法を選択することがある。

【骨膜縫合】

● 歯肉弁根尖側移動術

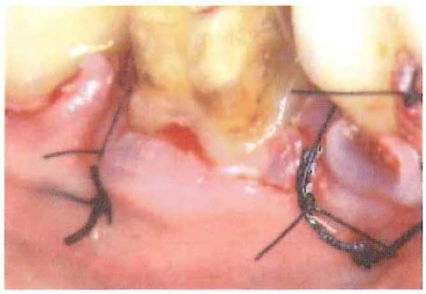

No.14 (3-0 シルク/ブレイド)を使用。歯肉弁を根尖側に移動して固定するのに用いる縫合法である。

品番 針長/糸長	針		糸
	形状	湾曲	太さ・種類
3 18mm/45cm	逆三角	弱湾	4-0 シルク(ブレイド)
14 13mm/45cm	丸	強湾	4-0 シルク(ブレイド)
19 13mm/45cm	逆三角	弱湾	5-0 ナイロン(モノフィラメント)
24 18mm/45cm	逆三角	弱湾	3-0 シルク(ブレイド)

QRコードから
カタログをチェック

医療機器承認番号 20900BZZ00869000
高度管理医療機器 一般的名称:滅菌済み絹製縫合糸
販売名 マニーシルク

医療機器承認番号 21100BZZ00049000
高度管理医療機器 一般的名称:ポリアミド縫合糸
販売名 マニーナイロン


滅菌済針付縫合糸

医療機器承認番号　20900BZZ00869000
高度管理医療機器　一般的名称：滅菌済み絹製縫合糸
販売名　マニーシルク

医療機器承認番号　21100BZZ00049000
高度管理医療機器　一般的名称：ポリアミド縫合糸
販売名　マニーナイロン

医療機器承認番号　21100BZZ00050000
高度管理医療機器　一般的名称：ポリエステル縫合糸
販売名　マニーポリエステル

優れた切れ味。錆びにくく折れにくい、自社開発のマニーハードファイバーステンレススチールと、独自のレーザー微細加工技術でつくられています。

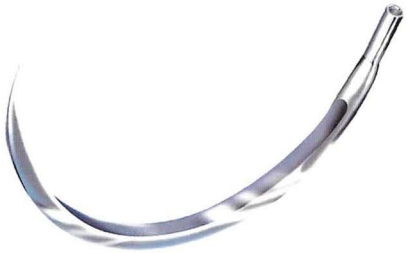



特別価格

■標準価格（12本入／1箱）
#1～29
~~7,000円~~（税別）

全品番ラインナップ

注文番号	縫合針	縫合糸
売れ筋 No.2 1	逆三角 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
2	逆三角 強弯 針長 25mm 針部径 0.73mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
売れ筋 No.1 3	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 4	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.38mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 5	先端角 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
6	丸 直 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
7	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
8	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
9	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.43mm	5-0 ポリエステル ブラックブレード 45cm(18")
10	丸 強弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
11	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.73mm	2-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
12	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
13	丸 釣針 針長 16mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
14	丸 強弯 針長 13mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
15	丸 強弯 針長 16mm 針部径 0.53mm	4-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")

注文番号	縫合針	縫合糸
16	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.63mm	3-0 ナイロン ブラックブレード 45cm(18")
17	丸 強弯 針長 20mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
18	逆三角 弱弯 針長 11mm 針部径 0.43mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
売れ筋 No.3 19	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.38mm	5-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
20	逆三角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
21	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
22	逆三角 強弯 針長 16mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
23	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 ナイロン ブラックモノフィラメント 45cm(18")
24	逆三角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	3-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
25	丸 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
26	丸 弱弯 針長 18mm 針部径 0.58mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 27	先端角 弱弯 針長 13mm 針部径 0.43mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 28	先端角 強弯 針長 16mm 針部径 0.48mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")
おすすめ 29	先端角 弱弯 針長 18mm 針部径 0.53mm	4-0 シルク ブラックブレード 45cm(18")

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。

MIステンレスバー・ステンレスバーハード【シャンクタイプ:CA】

錆びに強く、オートクレーブ可能



医療機器届出番号　09B1X00006001010
一般医療機器　一般的名称：歯科用スチールバー
販売名　マニーステンレスバー

MI重視

- MI(ミニマルインターベーション)
- 軟化象牙質を選択的に除去

	全長	最高許容回転数
	22mm	1,200min^{-1}
	28mm	1,200min^{-1}
	34mm	800min^{-1}

※34mmは、#2と#6のみ

サイズ	刃部最大径
1／2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

■最小包装単位:6本入／ケース
■規格:22、28mm:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
:34mm:2、6

特別価格

■標準価格
(6本入／1ケース)
~~3,200円~~(税別)

医療機器届出番号　09B1X00006001020
一般医療機器　一般的名称：歯科用スチールバー
販売名　マニーステンレスバーハード



切削性重視

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



	全長	最高許容回転数
	22mm	4,000min^{-1}
	28mm	4,000min^{-1}

サイズ	刃部最大径
1／2	0.6mm
1	0.8mm
2	1.0mm
3	1.2mm
4	1.4mm
5	1.6mm
6	1.8mm
7	2.1mm
8	2.3mm

■最小包装単位:6本入／ケース
■規格:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8
■アソート:1～6

特別価格

■標準価格
(6本入／1ケース)
~~3,200円~~(税別)

ホームページをリニューアルしました。



医療関係者向けサイト

製品情報やカタログ、イベントの情報はこちら



コーポレートサイト

企業情報はこちら

Instagramでも情報を発信中!

セミナーや展示会情報など、ぜひ、フォローお願いします!

MANI_DENTAL_JP

製造販売　マニー株式会社　〒321-3231　栃木県宇都宮市清原工業団地8番3
【国内営業G】　Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593　URL:http://www.mani.co.jp

発　売　株式会社モリタ
大阪本社　■〒564-8650　大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号　Tel:06-6380-2525
東京本社　■〒110-8513　東京都台東区上野2丁目11番15号　Tel:03-3834-6161

マニー オータムキャンペーン

ご注文書 ①

JIZAI セット

No. ＼ 長さ	コードNo.202490384 21mm	25mm	コードNo.202490369 21mm	25mm
グライドパスセット			シェイピングセット	
合　計			合　計	

JIZAI

コードNo.202490370〜376、382、383

No. ＼ 長さ	18mm	21mm	25mm	No. ＼ 長さ	21mm	25mm
オリフィスオープナー 25(.14)				40(.04)		
Pre 013(.04)				45(.04)		
Pre 020(.04)				50(.04)		
25(.04)				25(.06)		
30(.04)				30(.06)		
35(.04)				35(.06)		
合　計				合　計		

滅菌済針付縫合糸

コードNo.202390160

番　号	個　数
合　計	

Dファインダー

コードNo.202390410、411

No. ＼ 長さ	21mm	25mm
08		
10		
12		
15		
合　計		

グライドファインダー

コードNo.202490380、381

No. ＼ 長さ	21mm	25mm
08		
10		
12		
15		
合　計		

MIステンレスバー

コードNo.202490696〜698

No. ＼ 長さ	22mm	28mm	34mm
1／2			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
1〜6(アソート)			
合　計			

ステンレスバーハード

コードNo.202490689、202490699

No. ＼ 長さ	22mm	28mm
1／2		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
1〜6(アソート)		
合　計		

Kファイル

コードNo.202390052〜055

No. ＼ 長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15〜40(アソート)				
合　計				

コードNo.202390056〜059

No. ＼ 長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
06				
08				
45				
50				
55				
60				
70				
80				
45〜80(アソート)				
合　計				

リーマ

コードNo.202390040〜043

No. ＼ 長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
10				
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15〜40(アソート)				
合　計				

コードNo.202390044〜047

No. ＼ 長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
06				
08				
45				
50				
55				
60				
70				
80				
45〜80(アソート)				
合　計				

RTファイル

コードNo.202390400、401、404、405

No. ＼ 長さ	21mm	25mm	28mm	31mm
15				
20				
25				
30				
35				
40				
15〜40(アソート)				
合　計				

ご注文　2026年　　月　　日　　キャンペーン期間 2026年10月21日(水)→11月20日(金)

お名前　　貴医院名

ご住所　〒　　ー

TEL　　(　　)

お出入りの歯科商店名

マニー オータムキャンペーン

ご注文書 ②

Hファイル

No. ＼ 長さ	コードNo.202390064～067 21mm	25mm	28mm	31mm	コードNo.202390068～071 21mm	25mm	28mm	31mm
10					08			
15					45			
20					50			
25					55			
30					60			
35					70			
40					80			
15～40（アソート）					45～80（アソート）			
合　計					合　計			

GPR（ガッタパーチャリムーバー）

コードNo.202390380～382

No.	個　数	No.	個　数
1S		3N	
2S		4N	
		アソート（ASS）	
合　計		合　計	

サージカルバーFG

コードNo.202490390～396

No. ＼ 長さ	25mm	28mm	30mm
MZB⁺			
2			
330			
1557			
1559L			
合　計			

中間リーマ

コードNo.202390090、091

No. ＼ 長さ	21mm	25mm
12		
17		
22		
27		
32		
37		
アソート		
合　計		

中間Kファイル

コードNo.202390092、093

No. ＼ 長さ	21mm	25mm
12		
17		
22		
27		
32		
37		
アソート		
合　計		

中間Hファイル

コードNo.202390094、095

No. ＼ 長さ	21mm	25mm
12		
17		
22		
27		
32		
37		
アソート		
合　計		

ダイヤバーFGブリスターパック

コードNo.202490639～659、662、685、631、632

形態番号	個　数	形態番号	個　数
合　計		合　計	

ピーソリーマ

コードNo.202390460～462

No. ＼ 長さ	28mm	32mm	38mm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
1～6（アソート）			
合計			

ゲーツドリル

コードNo.202390143～145

No. ＼ 長さ	28mm	32mm	38mm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
1～6（アソート）			
合計			

IPR用ダイヤバー

コードNo.202490686

No.	個　数
IPR-01EF	

Mカーバイドバー+

〈Ⅰクラス〉コードNo.202490406 形態番号	個　数	〈Ⅱクラス〉コードNo.202490407 形態番号	個　数	〈Ⅲクラス〉コードNo.202490408 形態番号	個　数
合　計		合　計		合　計	

ご注文　2026年　　月　　日　　キャンペーン期間　2026年10月21日(水)→11月20日(金)

お名前　　貴医院名

ご住所　〒　　ー

TEL　　(　　)

お出入りの歯科商店名

●本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。
●特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。
●勝手ながらRTファイルの#45～80、リーマ・K・Hファイルの#90～140、18mmリーマ・ファイルは対象外とさせていただきます。
●商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。

■セールを実施していない地域がございます。予めご了承ください。
■掲載商品の標準価格は2026年10月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。
■数量に限りがありますので、期間中でもセールを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。
■お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。
■掲載されているコードNoは発売元㈱モリタのコードNoです。