



歯周検査、ひとりで完結。

検査圧を一定に保ち、フットスイッチで数値入力。補助なしで、ぶれないポケット検査を。

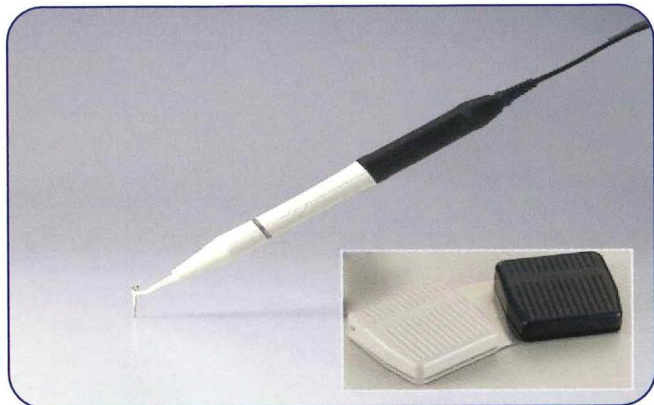

PerioPam 本体 + フットスイッチ

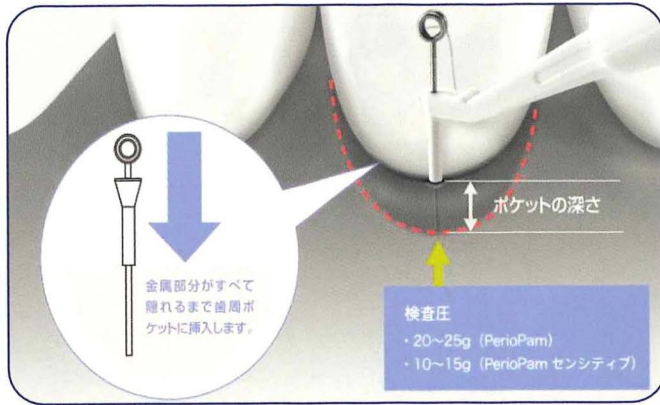

検査圧と挿入イメージ

01 人を選ばない

手指の感覚に頼らず、数値のばらつきを抑えます。

02 筆記が不要

フットスイッチ入力で、記録の手間を軽減。

03 検査効率の向上

経験差が出にくく、スタッフ不足を解消。

<キャンペーン実施中！>

期間：2026.10.1～2027.3.31 ご契約分

通常 医院様価格
¥ ~~207,000~~ (税別)

キャンペーン価格
¥ **139,000** (税別)

68,000円 お得 (33% OFF)

セット内容	通常価格	キャンペーン価格
PerioPam本体または、PerioPamセンシティブ本体	¥128,000	¥65,000
PerioPam用USB 2連無線フットスイッチ	¥70,000	¥66,000
PerioPam 専用耐久 USB ケーブル (2m)	¥9,000	¥8,000
合 計 (税別)	¥207,000	¥139,000

※PerioPamをご利用いただくには、別売のPerioPam ディスポヘッド（7mm／13mm／アソートのいずれか）が必要になります。

一般的名称 JMDN70697000 歯周ポケット測定器 / 機器の分類 クラスII管理医療機器 特定保守管理医療機器 / 認証番号 228AIBZX00027000

▶ 訪問・Zoom デモを承ります

実機の操作感をその場でお確かめいただけます。地域に応じてZoom対応とさせていただきます場合がございます。

製造販売元

株式会社ナルコーム

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239

営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町11-5 明治安田生命松戸ビル5階

TEL 047-364-7656 / FAX 047-364-7657

E-mail info@narcohm.co.jp URL <https://www.narcohm.co.jp/>