



歯科用ゴム製研磨材

グロスマスター ZR

ジルコニア・ニケイ酸リチウムを 2ステップ研磨で滑沢に

時短

耐久性◎

MEDIUM

Step 1



FINE

Step 2



ラボサイド新形態
D25登場!



◆ ダイヤモンド砥粒含有

GLOSS MASTER ZR

製品WEBサイトは
こちら



SHOFU INC.



ジルコニア・ニケイ酸リチウムの中仕上げ・最終仕上げ研磨に

2ステップ研磨で効率的に


ジルコニアの研磨がミディアム→ファインの2ステップ※¹で完了。
弊社従来品(ジルコシャイン)と比較し**研磨時間を約40%短縮**※²します。

※¹ 口腔外の場合はミディアム→ジルグロスのステップがより早く仕上がります。

※² 下記自社試験にもとづく

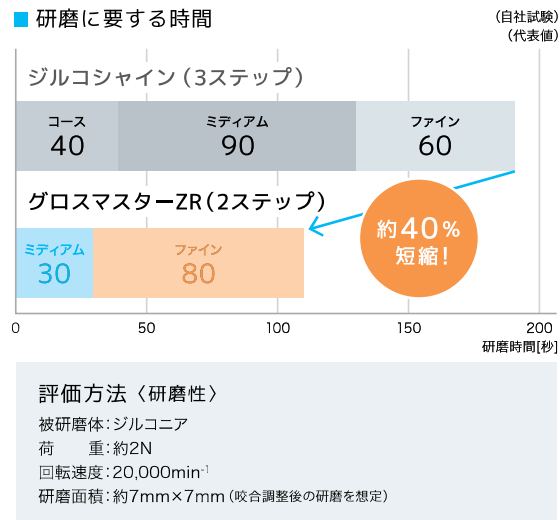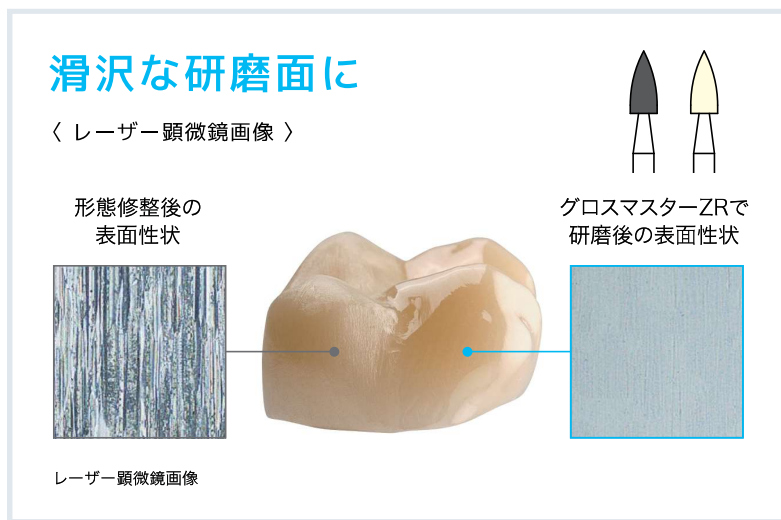

すぐれた耐久性

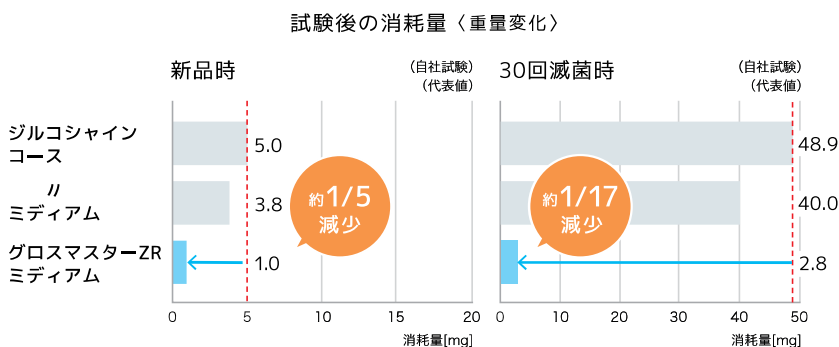

従来品よりも**耐久性が向上**。
同条件下で研磨した場合の**消耗量は大幅に減少**しており、繰り返し使用できます。

評価方法〈耐久性〉
被研磨体:ジルコニア
荷重:約2N
回転速度:20,000min⁻¹
研磨時間:30秒
滅菌方法:オートクレーブ滅菌(134°C,3分)

◆ 研磨性と耐久性が高い理由


松風独自の特殊バインダーを採用

砥粒の保持力が高く、砥粒が脱落しにくい

バインダーそのものの強度が高い

特殊バインダー

ダイヤモンド砥粒

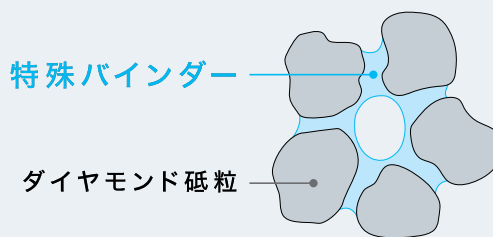

※イメージ図

◆ さまざまな用途に対応可能な形態ラインアップ

CAタイプ




新形態 "D25"

マンダレルのネジ部が内部に収まっているため、補綴装置に干渉しません。

片テーパ形状のため狙った部分のみにアクセスできます。

D25 | ブリッジ連結部、鼓形空腔に

HPタイプ

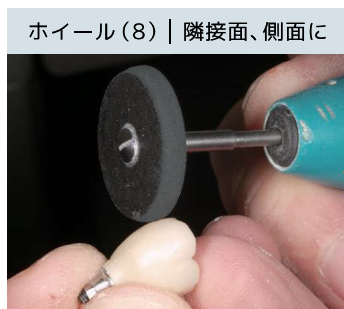

研磨動画



チェアサイド編



ラボサイド編

研磨ステップ

口腔内



中仕上げ
グロスマスター ZR
ミディアム



最終仕上げ
グロスマスター ZR
ファイン

口腔外/ラボサイド



中仕上げ
グロスマスター ZR
ミディアム

ジルグロス ①

11 ファイン ②

or

ジルグロスの方が早くなめらかな面に仕上がります。

最終仕上げ
①ジルグロス
or
②グロスマスター ZR
ファイン

◇ 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ジルコニア研磨キット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000297
グロスマスター ZR	歯科用ゴム製研磨材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000296


◇ 包装・価格



松風ジルコニア研磨キット

ジルコニア・ニケイ酸リチウム製補綴装置の口腔内における形態修整から最終仕上げ研磨を行えるキットです。

- ・松風 ビトリファイドダイヤ CA 28,29
- ・グロスマスター ZR CA ファイン 28,29S
- ・グロスマスター ZR CA ミディアム 28,29S
- ・パーステーションII (ブルー)

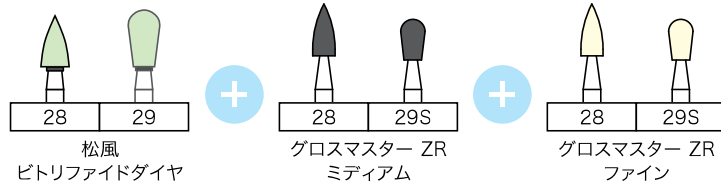

〈 最高許容回転速度 〉 松風 ビトリファイドダイヤ 30,000min⁻¹
グロスマスター ZR 20,000min⁻¹



グロスマスター ZR

- CA (3本入) 28, 29S
- HP (1個入) ホイール (8)
- HP (3本入) 28
- HP (1個入) D25
- HP (3本入) 13SS
- HP (2本入) 11

※ホイール (8)、D25はマンドレル (HP) が1本付属します。

形態ラインアップ	28	29S	13SS	11	ホイール (8)	D25
CA	ミディアム	○	-	-	-	-
	ファイン	○	-	-	-	-
HP	ミディアム	-	○	○	○	○
	ファイン	○	-	○	-	-
最高許容回転速度	20,000min ⁻¹				15,000min ⁻¹	

◇ 関連製品

歯科用研削器材
医療機器届出番号: 26B1X00004000226



松風 ビトリファイドダイヤ
FG (3本入) 25, 28
CA (3本入) 28, 29, 43
HP (3本入) 28, 29, 42, 43
HP (2本入) 11
HP (3本入) 20
HP (2本入) 10, 70

歯科用研磨器材
医療機器届出番号: 26B1X00004000269



ジルグロス
20g
40g

歯科用研磨器材
医療機器届出番号: 26B1X00004000150



松風ピボットブラシ [HP]
12本入



ダイヤモンドドレッサー
1本入

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店